

ENGLISH

- Material: Titanium/Carbon
- Weight Limit: 166kg
- Length: 250 / 400mm

	Torque	Loctite
Set Screws	15 Nm	243


For secure fastening use the loctite recommended and apply rated torque twice.

Cutting and assembly of Carbon Tube:
The tube should be shortened according to measurements. Avoid damage to tube as it may prevent easy insertion into Tube Clamp Adapter.

- Remove Tube Insert.
- Clamp tube with a 30mm cutting jig.
- Ensure tube is cut straight with a fine tooth saw.
- Remove all burs with a file.
- Replace Tube Insert before inserting into Tube Clamp Adapter.
- Ensure tube is fully inserted and in firm contact with base of Tube Clamp Adapter.

2 year limited warranty.

Rated to 166kg / 366lbs, is not recommended for active use.

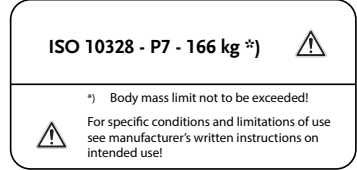

DEUTSCH

- Material: Titan/Karbon
- Gewichtsgrenze: 166kg
- Länge: 250 / 400mm

	Drehmoment	Loctite
Sicherheitsschrauben	15 Nm	243

Verwenden Sie für eine sichere Fixierung das empfohlene Loctite und wenden Sie das Nenndrehmoment zweimal an.


Zuschnitt und Aufbau des Karbonrohrs:
Das Rohr sollte maßgerecht gekürzt werden. Vermeiden Sie eine Beschädigung des Rohres, um ein problemloses Einführen in den Rohrklemmadapter zu sichern.

- Entfernen Sie den Rohreinsatz.
- Klemmrohr mit 30mm Schnittkerbe.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohr mit einer feinen Zahnsäge gerade abgeschnitten wird.

- Feilen Sie sämtliche Unebenheiten ab.
- Vor dem Einführen in den Rohrklemmadapter muss der Rohreinsatz wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohr komplett einges- etzt ist und fest unten im Rohrklemmadapter sitzt.

Garantie: 2 Jahre

Getested für bis zu 166kg / 366lbs, nicht für den aktiven Gebrauch empfohlen.

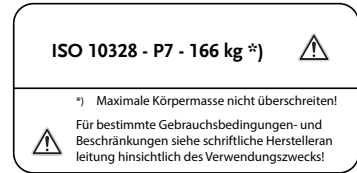

FRANÇAIS

- Matériau: Titane/Carbone
- Poids Limite : 166kg
- Longueur: 250 / 400mm

	Serrage	Adhésif
Jeu de vis	15 Nm	243


Pour garantir une bonne attache, utiliser l'adhésif recommandé et serrer deux fois.

Découpage et montage du tube en carbone:
Le tube devra être raccourci selon les mesures requises. Eviter d'endomager le tube : ceci pourrait empêcher une insertion aisée dans l'adaptateur du collier de serrage du tube.

- Retirez la pièce d'insertion du tube.
- Serrez le tube à l'aide de la pièce coupante de 30 mm.
- Assurez-vous que la découpe du tube est régulière (utilisez une scie à dent fine).
- Retirez tous les déchets à l'aide d'une lime.
- Remplacer le Dispositif d'Insertion de Tube avant de l'insérer dans l'Adaptateur du Clamp de Tube.
- S'assurer que le tube est complètement inséré et en contact ferme avec la base de l'Adaptateur du Clamp de Tube.

Garantie: 2 années

166 kg / 366 lb nominal, n'est pas recommandé pour une utilisation active.

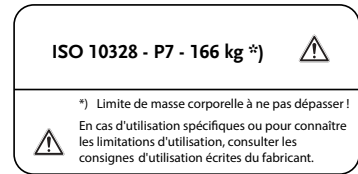

ESPAÑOL

- Material: Titanio/Carbono
- Peso límite: 166kg
- Largo: 250 / 400mm

	Par de ajuste	Loctite
Tornillo de retención	15 Nm	243


Para lograr una fijación segura, utilice el loctite recomendado y aplique dos veces el par de ajuste indicado.

Cómo cortar y ensamblar el tubo de carbono:
Corte el tubo de acuerdo a las medidas correspondientes. Evite dañar el pistón, dado que esto podría dificultar su inserción en el adaptador de la abrazadera del tubo.

- Retire el inserto del tubo.
- Sujete el tubo con una plantilla de corte de 30mm.
- Asegúrese de efectuar un corte recto y parejo en el tubo, usando una sierra de dientes finos.
- Lime todas las rebabas.
- Sustituya el inserto antes de introducirlo en el adaptador de la abrazadera del tubo.
- Asegúrese de que el tubo haya quedado totalmente introducido y que esté en contacto firme con la base del adaptador de la abrazadera del tubo.

Garantía: Limitada a 2 años

Soporta un peso máximo de 166 kg /366 lb, no se recomienda para un uso activo.

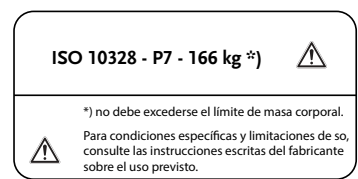

ITALIANO

- Materiale: Titanio/Carbonio
- Peso max.: 166kg
- Lunghezza: 250 / 400mm

	Torsione	Loctite
Viti fissaggio	15 Nm	243


Per fissarlo, utilizzare il prodotto Loctite consigliato e applicare la torsione nominale due volte.

Taglio e assemblaggio del tubo in carbonio:
Il tubo devessere accorciato secondo le misurazioni. Evitare di danneggiare il pilone, in quanto ciò può impedire un facile inserimento nell'adattatore a morsetto del tubo.

- Rimuovere l'inserto del tubo.
- Assicurare il tubo su un dispositivo da taglio da 30mm.
- Assicurarsi che il tubo sia tagliato dritto con un sottile seghetto odontoiatrico.
- Togliere tutte le sbavature con una lima.
- Riposizionare l'inserto del tubo prima dell'inserimento nell'adattatore.
- Assicurarsi che il tubo sia interamente inserito ed in stretto contatto con la base dell'adattatore.

Garanzia: Limitata a 2 anni

Valutata a 166kg / 366 lb, non è consigliata per un uso attivo.

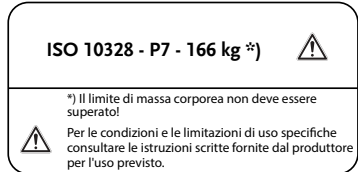

DANSK

- Materiale: Titanium/Kulfiber
- Vægtgrænse: 166kg
- Længde: 250 / 400mm

	Moment	Loctite
Justeringskruer	15 Nm	243


Brug den anbefalede loctite, og anvend klassificeret moment to gange for at opnå sikker fastspænding.

Tilskæring og samling af kulfiberrøret.
Røret skal forkortes i overensstemmelse med målene. Undgå at beskadige røret, da det vil kunne skabe problemer med at fastgøre røradapteren.

- Fjern rørindsatsen.
- Spænd røret fast på en 30 mm skæreblok.
- Vær sikker på, at røret skæres lige igennem med en fintandet sav.
- Fjern alle ru kanter med en fil.
- Sæt rørindsatsen fast igen.
- Vær sikker på, at røret er helt fastgjort, og at det stemmer fast imod røradapteren.

Garanti: Op til 2 antal år.

Dimensioneret til 166 kg. Anbefales ikke til aktiv brug.

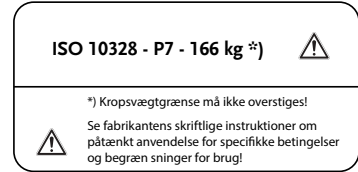

SVENSKA

- Material: Titan/Kolfiber
- Vikt max: 166kg
- Längd: 250 / 400mm

	Moment	Loctite
Justerskruvar	15 Nm	243


För säker fästning använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet två gånger.

Kapning och montering av kolfiberrör:
Röret skall kortas enligt måttanvisningar. Undvik att skada røret då det kan försvåra montering av adaptern.

- Demontera rörinsatsen.
- Spänn fast røret med en 30 millimeters jigg.
- Se till att røret kapas rakt av med en fintandad såg.
- Ta bort grader med en fil.
- Montera rörinsatsen innan røret skjuts in i adaptern.
- Se till att røret är helt inskjutet och vilar s tadigt mot adapterns botten.

Garanti: 2 års begränsning.

Godkänd för upp till 166 kg, rekommenderas inte för aktiv användning.

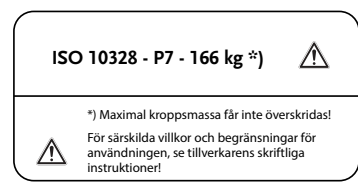

NEDERLANDS

- Materiaal: Titanium/Koolstof
- Gewichts limiet: 166kg
- Lengte: 250 / 400mm

	Draaitot	Loctite
Vaste schroeven	15 Nm	243

Gebruik voor het goed vastzetten de aanbevolen loctite en pas de vastgestelde torque twee keer toe.


Het snijden en samenstellen van de koolstof buis:

De buis dient op maat ingekort te worden. Vermijd beschadiging van de buis, om gemakkelijk insteken in de buisklem adapter te verzekeren.

- Verwijder de buis insteek
- Klem de buis vast met een 30mm snijder.
- Zorg dat de buis recht is afgezaagd, met een fijne tandzaag.
- Verwijder alle oneffenheden met een vijl
- Plaats de buis insteek terug voordat u het geheel in de buisklem adapter steekt.
- Zorg dat de buis helemaal ingestoken is en goed contact maakt met de basis van de buisklem adapter.

Garantie: 2 jaar beperkt

Belastbaar tot 166 kg/366 lb., niet aanbevolen voor actief gebruik.

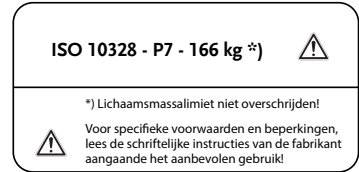

PORTUGUÊS

- Material: Titânio/Carbono
- Peso Limite: 166kg
- Comprimento: 250 / 400mm

	Torque	Loctite
Parafuso de Aperto	15 Nm	243


Para uma fixação segura, utilizar o Loctite recomendado e aplicar duas vezes a força de aperto nominal.

Cortar e Montar o Tubo de Carbono:
O tubo deve ser cortado à medida correcta. Evite danificar o tubo, já que tal dificulta a inserção deste no Adaptador de Grampo.

- Remova o Encaixe do Tubo.
- Fixe o tubo com uma guia de corte de 30mm.
- Use um serrote com fôlha de dentes finos para cortar o tubo à esquadria.
- Remova as rebarbas com uma lima ou rebarbadora.
- Substitua o Encaixe do Tubo antes de introduzir no Adaptador de Grampo.
- Assegure-se de que o tubo se encontra completamente introduzido e em contacto com a base do Adaptador de Grampo.

Garantia: Limite 2 ano.

Classificado para 166kg / 366lbs, não recomendado para uso ativo.

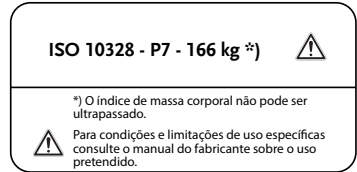

日本語

- 材質：チタン / カーボン
- 使用者の体重制限：166kg
- 長さ：250 / 400mm

	締め付けトルク値	ロックタイト
ピラミッド調節ジ	15Nm	243


安全に取り付けるためには、推奨されるロックタイトを使用して、トルクを 2 度適用してください。

カーボンチューブのカットと組み立て：
採寸値に応じて、チューブの長さを調整する。
チューブクランプアダプタへの挿入を妨げるようなダメージをチューブに与えないで下さい。

- チューブインサートを取り外します。
- チューブを 30mm の治具で留めます。
- よく切れる金鋸を用いてチューブをまっすぐにカットします。
- クランプアダプタに挿入する前に、やすりで全てのバリを取り除いて下さい。
- チューブクランプアダプタに挿入する前にチューブインサートを再び取り付けます。
- チューブが完全に挿入されているか、またクランプアダプタとしっかりと接触しているか、確認 して下さい。

限定保証：日本総代理店の出荷日より 2 年

定格は 166kg / 366lbs で、アクティブな使用には推奨されません。

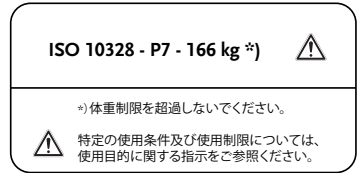

EN – Caution: Össur products and components are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Össur products are used with other recommended Össur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE – Hinweis: Össur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach betriebsinternen Normen geprüft. Die Kompatibilität mit bzw. die Einhaltung dieser Normen ist nur möglich, wenn die Össur-Produkte mit anderen empfohlenen Össur-Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleiß auftreten, ist der Patient darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und seinen Arzt oder Orthopädietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde für den Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und geprüft. Die Vorrichtung darf NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den Arzt.

FR – Attention: Les produits et composants Össur sont conçus et testés selon les normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas où aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Össur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Össur. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES – Atención: Los productos y componentes de Össur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Össur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

IT – Avvertenze: I prodotti ed i componenti Össur sono stati progettati e collaudati conformemente agli standard ufficiali applicabili o a uno standard interno in mancanza di standard ufficiali applicabili. La compatibilità e la conformità a tali norme sono garantite solamente se i prodotti Össur sono utilizzati in combinazione con altri componenti Össur consigliati. Qualora una parte strutturale del dispositivo mostri segni di usura anche meccanica, informare l'utente di sospendere immediatamente l'uso della protesi e di consultare il proprio tecnico ortopedico. Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato da un singolo utente e se ne sconsiglia l'impiego da parte di più utenti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

DA – Forsigtig: Össur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til de gældende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke findes en gældende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse standarder opnås kun, når Össur produkter anvendes sammen med andre anbefalede Össur komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pagældende protese og kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af en patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV – Var försiktig! Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller tillämpliga industristandarder eller lokala standarder där det inte finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast när Össur-produkter används med andra rekommenderade Össur-produkter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av produktens konstruktionsdelar, Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL – Opgelet: Össur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar toepasselijke, officiële maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen officiële maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen wordt alleen verkregen wanneer Össur producten en onderdelen met andere aanbevolen Össur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiënten wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT- Atenção: Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas oficiais aplicáveis ou normas internas definidas quando não seja aplicável nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos da Össur forem utilizados com outros componentes recomendados pela Össur. Se a qualquer momento for detetado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o paciente deve ser instruído a interromper de imediato o uso do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não deve ser utilizado em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contato com o seu especialista clínico.

日本語 注意: オスール製品および部品は当該の公的基準または企業指定基準 (公的基準が適用されない場合) に対応するよう設計され、検査されています。この規格の適合性及び準拠性は、オスール製品が他の推奨オスール部品と共に使用された場合にのみ有効です。 装具の構造部品に異常な動作や摩耗がみられたときはいつでも、装具の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。本品は患者1人へのみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直ちにかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

Össur Americas 27051 Towne Centre Drive Foothill Ranch, CA 92610, USA Tel: +1 (949) 382 3883 Tel: +1 800 233 6263 ossurusa@ossur.com	Össur Canada 2150 – 6900 Graybar Road Richmond, BC V6W 0A5 , Canada Tel: +1 604 241 8152	Össur APAC 2F, W16 B No. 1801 Hongmei Road 200233, Shanghai, China Tel: +86 21 6127 1707 asia@ossur.com
Össur UK Ltd Unit No 1, S:Park Hamilton Road Stockport SK1 2AE, UK Tel: +44 (0) 8450 065 065 ossuruk@ossur.com	Össur Nordic Box 770 191 27 Sollentuna, Sweden Tel: +46 1818 2200 info@ossur.com	Össur Australia 26 Ross Street, North Parramatta NSW 2151 Australia Tel: +61 2 88382800 infosydney@ossur.com
Össur Europe BV De Schakel 70 5651 GH Eindhoven The Netherlands Tel: +800 3539 3668 Tel: +31 499 462840 info-europe@ossur.com	Össur Iberia S.L.U Calle Caléndula, 93 - Miniparc III Edificio E, Despacho M18 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas Madrid – España Tel: 00 800 3539 3668 orders.spain@ossur.com orders.portugal@ossur.com	Össur South Africa Unit 4 & 5 3 on London Brackengate Business Park Brackenfell 7560 Cape Town South Africa Tel: +27 0860 888 123 infosa@ossur.com
Össur Deutschland GmbH Augustinusstrasse 11A 50226 Frechen Deutschland Tel: +49 (0) 2234 6039 102 info-deutschland@ossur.com	Össur Europe BV – Italy Via Baroaldi, 29 40054 Budrio, Italy Tel: +39 05169 20852 orders.italy@ossur.com	



www.ossur.com ©Copyright Össur 2019 IFU 0094 1402_001 Rev. 7



FEMALE PYLON

Titanium/Carbon

A-746020 / A-746010